

Bitte senden Sie uns nach ein paar Wochen Behandlungsdauer Ihre Erfahrungen mit unseren Geräten per Email etc. zu. Weiterhin schauen Sie auch unter [www.Bioparres.de](http://www.Bioparres.de) im Service, ob es für Ihr Gerät bereits eine erweiterte Anleitung zum Ausdrucken gibt. Bei gern zu vernehmender Kritik denken Sie bitte daran, dass jede einzelne Verfeinerung der Geräte den Verkaufspreis in die Höhe treiben würde. Dies ist nicht im Sinne unserer Kunden und Anwender. Daher liefern wir max. Funktion mit ausreichendem Design.

**Einstellung der Stärke: 18 Volt** = Batteriebetrieb o. Netzbetrieb + Regler ganz rechts in Uhrzeigersinn / **7 Volt** = Batteriebetrieb o. Netzbetrieb + Regler ganz links gegen Uhrzeigersinn (Regler in Mitte = 12 bis 13 Volt). **Verwenden Sie die Doppelpack-Batterien TopCraft Ultra von Aldi.**

**Betriebshinweise:** Das Gerät darf ausschließlich mit Originalzubehör betrieben werden. Experimente außerhalb dieser Zapperanleitung können zu Schädigungen für Mensch und Gerät führen. Das Gerät muss immer trocken und temperiert gelagert werden ( z.B. im Winter nicht im Auto belassen ). Wenn das Gerät Feuchtigkeit oder Kälte ausgesetzt war, dann muss es erst mind. 30min. uneingeschaltet und temperiert gelagert werden, bevor es eingeschaltet wird. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise wird die Garantie unwirksam. **Funktionstest: Beim Blutzappen muss die LED Lampe blinken. Ansonsten schicken Sie das Gerät zur Reparatur ein.** Weiterhin müssen die einzelnen Stromimpulse (Blutzappen bei 18 Volt u. vollen Batterien) deutlich spürbar sein. Beim **Parasiten Zappen Clark leuchtet die LED** nur und das Kribbeln ist nicht so stark wie beim Blutzappen.

#### **Hinweise zum Zappen nach Clark (0) u. bioenergetischem Zielzappen Hickmann Erdfrequenz (II) :**

Wer das erste Mal zapft, sollte vorerst mit **7-9 Volt** anfangen und kann dann nach etwa 2 Wochen auf **18Volt** (außer Blutzappen (I) Baklayan) erhöhen. Beim Zappen können Erstverschlimmerungen wie etwa bei der Homöopathie auftreten. Damit ist erkennbar, dass im Körper etwas passiert. Wenn diese länger anhalten, verringern Sie die Zapzeiten auf (3,20,3,20,3) oder pausieren das Zappen für 2-3 Tage, danach erst mit **7-9 Volt** wieder anfangen. Bei **7-9 Volt** bemerken die meisten Nutzer kein Kribbeln, die Frequenz liegt jedoch an und wirkt trotzdem. Für Funktions / Kribbeltest schalten Sie kurz um auf Schalterstellung I und evtl. wieder zurück, wenn Sie bei Clark 0 auch bei 18Volt nichts spüren.

#### **1. Anwendung mit: WICHTIG**

( Oberbegriff Parasiten = Pilze, Bakterien, Viren, Würmer, Erreger, Pathogene etc. )

**Cu-Rohre:** Handflächen, Rohre und Rohrzuberzieher (Stoff) immer richtig **nass machen** und **nach einiger Behandlungszeit erneut nass machen**. Rohre gelegentlich mit einem Kratzschwamm reinigen. Die Rohre dürfen nur **locker auf der Haut sitzen**, das Klettgummi-Halteband darf nur locker angebracht werden. **Nicht** zu fest ziehen und das Rohr **nicht** zu fest andrücken. Es dürfen **keine** Maßnahmen unternommen werden, die den Widerstand zur Haut verringern u. den Stromfluss damit erhöhen. Die Anschlussklemme muss vom Körper wegzeigen und darf ihn nicht berühren. **Handgelenkmanschetten (gelb):** unter fließendem Wasser **richtig nass machen**, einweichen und leicht abschütteln. Sie dürfen nur locker und **nicht** zu fest um die Arme gelegt werden (nähe Pulsader). Außen herum das Wasser abtupfen. Leichte anfängliche Hautausschläge in Nähe der Handmanschetten nach dem Zappen sind normal. Sie treten von Woche zu Woche immer weniger auf. Um evtl. Jucken nach der Behandlung einzudämmen, spülen Sie Ihre Arme an der behandelten Stelle 1-2 min. mit kaltem Wasser. Zwischendurch können die Rohre benutzt werden.

**Selbstklebeelektroden:** auf die Pulsadern kleben oder Zielzappen (Clark) an den Stellen Ihres Körpers, wo die Beschwerden etc. sind. Wenn es nicht mehr richtig klebt, können Sie die mitgelieferten Gummiklettbander oder normale Gummis zum Festhalten verwenden. Wenn es bei 18 Volt nicht mehr kribbelt und die Batterien aber voll sind, dann bestellen Sie neue Selbstklebeelektroden unter Zubehör auf [www.BioParRes.de](http://www.BioParRes.de). Die Zapperfunktion ist gegeben, auch wenn das Empfinden sich nur auf eine Seite beschränken sollte. Prüfen sie zwischendurch, ob die Anschlüsse noch richtig und **nicht** an der Haut anliegen, damit es an einzelnen Stellen **nicht** zu einem erhöhten Stromfluss kommen kann.

#### **2. Anschluss:** Kabelklemmen an Handgelenkmanschetten **oder** Rohre **oder** Selbstklebe-Elektroden (wenn vorhanden) anstecken.

Frauen: links = rotes Kabel , Männer rechts = rotes Kabel . Bioenergetischer Polungsunterschied von Natur aus.

Beim Zielzappen können Sie auch für den einen Pol eine Selbstklebeelektrode und für den anderen Pol ein Rohr benutzen.

#### **Clark-Methode - Parasitenzappen ( 0 ) ( 7 bis 18 Volt )** Quelle Infos: Buch „Heilung ist möglich“ Dr.Clark

Da die Frequenz viel zu schnell für das Auge ist, sieht man die LED bei dieser Methode nur leuchten und nicht blinken. U.a. vor einer zu erwartenden Erkältung zappen. Während einer Erkältung den Körper erst einmal entgiften lassen, dann weiter zappen. Immer viel Wasser trinken.

**3a. Programm nach Dr. Clark.** Zapperkabel erst ankleben und Zapper für 7min anschalten. **Parasiten\*** werden geschwächt o. vernichtet. Danach Zapper ausschalten – 20 bis 40 min. Pause. Der Zapper und die Kabel können in der Pause abgelegt werden. (freier bewegen in den Pausen) Armbänder am Arm belassen, damit sie nicht austrocknen. Kabel ankleben und Zapper das 2.Mal für 7min. anschalten. **Bakterien\*** oder **3b. Dauerzappen** 30-60 min. ohne Pause anwenden. Diese 2 Arten (Clark 3a und 3b) wenden Sie immer im Wechsel an. **Viren\***

**Standard:** Hände bzw. Handgelenke / **Zielzappen:** an den Stellen der Beschwerden des Körpers mittels Klebeelektroden oder Rohre.

#### **Nach Alan E.Baklayan - Zappen (I) (blinkt) nur bei etwa 9 Volt** Quelle DVD "Blutparasiten 2" HP Baklayan

**3.** Zapper ohne Pause für 7 min. ankleben und anschalten, nach einer Stunde wiederholen. Fertig. Zapper erst ausschalten dann Kabel abstecken. Man spürt diese Frequenz bei 9V nur minimal, das ist aber normal. Die Leuchtdiode sieht man jetzt blinken mit 3,6 Hz.

Häufigkeit/Empfehlung: zur Vorsorge 2 x wöchentlich, bei Krankheit 2 x täglich. **Handgelenkmanschetten oder Rohre an 2 Armen, wie beim Clark-Zappen.** Evtl. aufgelöste Geldrollen (anfängliche Verklumpungen) der roten Blutkörperchen kann man frühestens nach 6 Stunden unterm Mikroskop sehen. Vor Operationen (auch Zahn Operationen) o.ä. darf kein Blutzappen gemacht werden.

#### **Nach Hickmann - Blutelektrofizierung (I) (blinkt) 10 bis 15 Volt - ähnlich Beck , Regler soweit zurückdrehen (links gegen Uhrzeigersinn) bis Sie es gerade noch spüren. Wenn Sie täglich behandeln, dann täglich den Arm wechseln.**

**3.** Zapper ohne Pause für 20min. bis max. 1 Stunde ankleben und anschalten. Fertig. Wenn Sie max. 2 Stunden täglich zappen wollen, dann früh 1 Stunde und abends 1 Stunde. Nach Behandlung die Behandlungsstellen mit gut verträglicher Creme leicht einschmieren. Zapper erst ausschalten dann Kabel abstecken. Man spürt diese Frequenz langsamer und intensiver, das ist aber normal. Die Leuchtdiode sieht man jetzt blinken mit 3,6 Hz. Bei zu großen Erstverschlimmerungen pausieren Sie. Leiten Sie Ihre freigesetzten Giftstoffe und Zellrümer mit Ozonwasser aus. 5 Stunden nach Einnahme von Ozonwasser sollte Vitamin C eingenommen werden um freie Radikale zu binden. **Beide Handgelenkmanschetten an einem Arm nahe Pulsader in etwa 3-5cm Abstand** (siehe Bild). **Stärke: bei Vertauschung der Anschlusskabel ist das Blutzappen 1x intensiver und 1x schwächer, deshalb immer** (siehe Bild) **in Nähe Hand das rote Kabel.** Das Durchschlafen dient nur der besseren Befestigung. Vor Operationen (auch Zahn Operationen) o.ä. darf kein Blutzappen gemacht werden. 3h vor und während des Blutzappens dürfen kein Knoblauch, Kräuter oder Medikamente (bis 30fache Wirkung) eingenommen werden. 1h danach kann alles eingenommen werden.

#### **Nach Hickmann - bioenergetisches Zielzappen ( II )** (bevorzugt 18 Volt) Entspannung, Harmonisierung, Kopfschmerzen, Tumor Zielzappen etc. . Dauerzappen 30-60min. Zur Vorsorge 2 x wöchentlich , bei Krankheit 2 x täglich.

**3.** Beim bioenergetischen Ziel-Zappen Hickmann behandeln Sie bitte Ihre Beschwerden mit Rohren oder Selbstklebeelektroden 18Volt gezielt.

Batterien bitte so einlegen



#### **Technische Daten:**

**Batteriebetrieb / Netzbetrieb 7-18 Volt**

Freq. nach Dr.Clark Baklayan /Hickmann Hickmann Erdfrequenz

34-36 KHz 3,6 Hz 7,8 - 7,9Hz

Stromaufnahme Mensch unter 5mA bei Körperlastwiderstand etwa 5 KOhm. **Bei Netzbetrieb schalten die Batterien autom. ab.** Absicherung Netzteil DC 18Volt im Zapper zusätzlich (100mA/M) Auslösung bei defekter Schaltung. Es darf nur ein DC ( Gleichspannung ) Netzteil 18 Volt verwendet werden. Andere Netzteil können das Gerät zerstören, die Funktion, Wirkung und die Frequenz beeinträchtigen. Bei Auslösen der Sicherung darf nur eine neue Sicherung mit 100mA/M verwendet werden, da sonst Frequenzabweichungen und Schädigungen für Gerät und Mensch möglich sind. Bei Auslösen der Sicherung ist das Gerät zur Reparatur beim Verkäufer/Hersteller einzuschicken, da auch spezielle Kalibrierungen der Frequenzen vorgenommen werden müssen.



Messen der Ausgangsspannungen sind mit einem normalen Messgerät unrealistisch, da Sie nur den Mittelwert anzeigen (bei 18V = 9V und bei 9V = 4,5V). Mit einem Oszilloskop ist die volle Amplitudenspannung messbar. Messungen der regelbaren Ausgangsspannung/Änderung sind nur mit einem zusätzlichen externen parallelen Lastwiderstand (etwa 5KOHM) oder im angeschlossenen Zustand des Zappers an Ihrem Körper möglich.

**Haftungsausschluss:** Die Anwendung des Zappers schließt nicht den Besuch beim Arzt aus. Wir übernehmen keinerlei Haftung und versprechen keinerlei Heilerfolge. Es sind keine Nebenwirkungen bei der Benutzung eines Zappers bekannt. Die Anwendung in der Schwangerschaft und bei Herzschrittmachern wird nicht empfohlen. Der Anwender dieses Gerätes haftet in Allem für sich selbst. Dieser Zapper ist kein medizinisches Produkt und er erbringt mit der Anwendung keinerlei medizinische Ansprüche oder Beweise. [www.Bioparres.de](http://www.Bioparres.de) / Silberbeschreibung auf Blatt 2

Klemmenanschluß bei Rohren mit Überzieher



Anschluss über Klemmen oder Druckknöpfe frei wählbar.

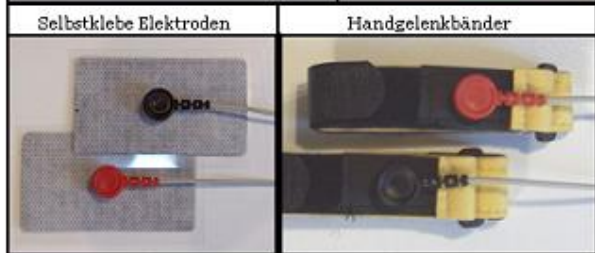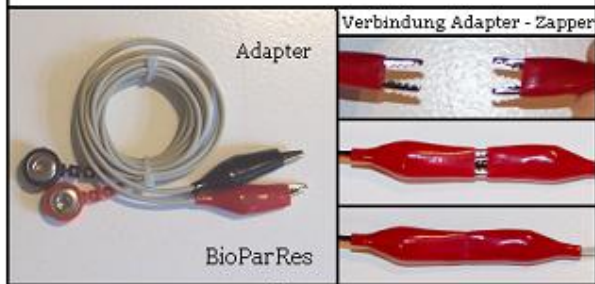

# BioParRes

Tel. 03520639268 Web: www.Bioparres.de

Höhere Wirkung mit 18 Volt DC.

## BioParRes Anleitung

### Hickmann Zapper Maxi

1. Parasiten Zapper (0) nach Dr.Clark
2. Blutelektrifizierung Hickmann ähnl.Beck ( I )
3. Zappen nach Baklayan ( I )
4. NEU bioenergetisches ( II ) Zielzappen nach Hickmann mit Erdfrequenz n.Schumann
5. Herstellung von kolloidalem Silber über extra Steckkontakte

( I )

Blutelektrifizierung Hickmann ähnl.Beck

1. Bitte beachten Sie die Farben.
2. Bänder müssen nass sein.



oder




oder



(c) Elektromeister Silvio Hickmann  
Schutz Marke: 302009023789

Anschluß **Parasitenzappen Clark (0)** sowie **Zappen nach Baklayan (I)**  
entweder oder

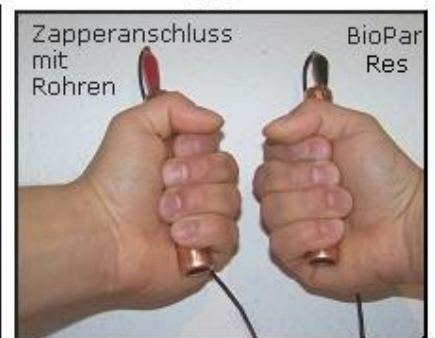

Ein Beispiel für **Zielzappen Clark (o)** oder **Energiezappen Hickmann (I I)** (Beides auch mit Klebeelektroden)



# Anleitung Silberherstellung - mit Hickmann Zapper Maxi + Silber

## Betriebshinweise:

Das Gerät darf ausschließlich mit Originalzubehör betrieben werden. Experimente außerhalb dieser Anleitung können zu Schädigungen für Mensch und Gerät führen. Das Gerät muss immer trocken und temperiert gelagert werden ( z.B. im Winter nicht im Auto belassen ). Wenn das Gerät Feuchtigkeit oder Kälte ausgesetzt war, dann muss es erst mind. 30min. uneingeschaltet und temperiert gelagert werden, bevor es eingeschaltet wird. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise wird die Garantie unwirksam. Für umfangreiche Anwendungen schauen Sie bitte in das beiliegende Buch.

## Richtige Herstellung.

Nur dest. Wasser ohne Zusätze verwenden, außer etwas altes KoSi. Vorher warm machen. Nach 30-50min. bei Dunkelheit sichtbar.



Ihr hergestelltes kolloidales Silber nur mit einem Holz- oder Plastiklöffel umrühren. Jeglicher Kontakt mit Metall schwächt die Ladung und damit die Wirksamkeit des kolloidalem Silbers ( KoSi ). KoSi dunkel und kühl lagern. Nicht im Kühlschrank und nicht in der Nähe elektrischer Geräte lagern. Nicht in die Nähe von Strahlquellen wie Handy, WLAN oder Schnurlostelefon sowie Basisstationen stellen.

Glas mit 200 - 400ml maximal dest. Wasser befüllen.

## Mengenverständnis

### Homöopathische Anwendung

= 1 Esslöffel unter die Zunge zum Setzen von Reizen etc.

### Medizinische Anwendung

(vorzugsweise)

1 bis 2x = halbes Glas nüchtern (je 100ml)

Kann auch kombiniert werden.

**Man sieht nur leichte Nebel die schweben.** Dauer 40-60 min. bei 200ml. Beim allerersten Mal ohne Starthilfe dauert es die doppelte Zeit. Bei Vergrößerung der Wassermenge muss die Herstellungsdauer auch entsprechend verlängert werden. Zur Beschleunigung der ersten Bildung der Kolloide das destillierte Wasser ohne Zusätze in einem Glastopf oder Kaffeekanne warm machen, ist aber nicht zwingend notwendig. Verwenden Sie nur destilliertes Wasser (z.B. vom Baumarkt mit der Aufschrift „chemisch rein“). Kein Osmosewasser etc. verwenden, da es für die Silberwasserherstellung immer noch zu unrein ist und dadurch zusätzliche unerwünschte Stoffe entstehen, die sich im Körper einlagern oder die Darmflora schädigen.

Als einzige Starthilfe können Sie ein wenig (etwa 10-20ml) altes selbst hergestelltes Silberwasser zum Neuanfang mit hinzugeben (wenn vorhanden in kleiner brauner Flasche). Andere Zusätze dürfen nicht verwendet werden. Neue Silberstäbe 99,99% bekommen Sie in unserem Onlineshop [www.Bioparres.de](http://www.Bioparres.de).

Zur Silberherstellung stecken Sie die beiden Stecker in die beiden Buchsen und schalten den linken EIN-Schalter mit LED ein, die Stellung des rechten Zapper-Wahl-Schalters ist dabei nicht relevant. Die Zapperkabel (rot,schwarz) mit den Kroko-Klemmen werden für die Silberherstellung nicht verwendet (wenn Sie sich geschickt anstellen, könnten Sie damit zur gleichen Zeit zappen) Nach etwa 20 min. Silber Herstellungszeit nehmen Sie kurz die Silberstäbe aus dem Wasser und wischen die Silberstäbe 1x grob mit einem Zellstofftaschentuch etc. ab. Danach setzen Sie die Herstellung fort. Diese Prozedur machen Sie dann alle 10-15 min. (also immer dann, wenn sich einer oder beide Stäbe sehr verfärbt haben). Da der Silbergenerator kurzschlussfest ist, muss er dabei nicht ausgeschaltet werden. Das fertige Silberwasser durch einen KoSi Filter filtern. Wenn Sie immer am Glas dunkle Stellen haben sollten, dann müssen Sie mit einem anderen Glas den Abstand der Silberstäbe zum Glas vergrößern. Die Silberstäbe sollten von 4cm bis 6cm ins Wasser eintauchen. Wenn Sie Früh und vorm Schlafengehen KoSi oral einnehmen, achten Sie darauf, dass Sie das auf nüchternen Magen tun, damit die Kolloide auch ins Blut gehen und nicht vorher gebunden werden. 15min. danach kann man wieder normal Nahrung + Getränke zu sich nehmen. Nach jeder Herstellung: 1. Silberstäbe mit einem Tuch abwischen 2. Mit mitgelieferten Stück grünen Kratzschwamm den Rest des schwarzen Belages entfernen, 3. noch mal mit einem Tuch nachwischen. Somit sind die Stäbe fertig für das nächste Mal.

## Technische Daten:

Spannung 18V DC, Strombegrenzung 6-7 mA, Elektrodenabstand 30mm.

### **Absicherung Netzteil DC 18Volt im Silberpulser zusätzlich (100mA/M) Auslösung bei defekter Schaltung oder unsachgemäßer**

**Bedienung.** Es darf nur ein DC ( Gleichspannung ) Netzteil 18 Volt verwendet werden. Andere Netzteil können das Gerät zerstören, die Funktion, Wirkung beeinträchtigen. Bei Auslösen der Sicherung darf nur eine 100mA/M verwendet werden, da sonst Schädigungen für Gerät und Mensch möglich sind. Betrieb ist mit Batterien oder Netzteil möglich.

**Haftungsausschluss:** Die Anwendung des Silbergenerators schließt nicht den Besuch beim Arzt aus. Wir übernehmen keinerlei Haftung und versprechen keinerlei Heilerfolge. Der Anwender dieses Gerätes haftet in Allem für sich selbst. Dieser Silbergenerator ist kein medizinisches Produkt und erbringt mit der Anwendung keinerlei medizinische Ansprüche oder Beweise.

## Im folgendem ein Beispiel für die unkorrekte Herstellung von kolloidalem Silber

Beispiel für viele andere Angebote im Netz. Zu schwere und große Teilchen fallen nach unten.

## Falsche Herstellung

1. Keine Strombegrenzung -> es entstehen zu große schwere Teilchen, die nicht wirken, sondern schädigen können. 2. kein dest. Wasser oder Zusätze im Wasser. Es entstehen schädliche Verbindungen.



Dies kann zu Ablagerungen und Nebenwirkungen führen ! © BioParRes Hickmann



**Anleitung Silberherstellung**

Mit der Silberfunktion des Hickmann Zapper Maxi

Zur Herstellung  
 von richtigen  
 kolloidalem Silber.

Ersatzgeräte (Umtausch) und Zapper unter [www.Bioparres.de](http://www.Bioparres.de)  
 (C) Elektromeister Hickmann

Deliverystadname  
 Herecaeus  
 Hannau

Dispatch from Rönnskåder Werks  
 March 16, 2009

**BOLIDEN**  
 Our reference  
 BCE Ewa Bergman

*SILVERANALYSES*

Analyses for silver granules 99,995%

Batch No.	Net weight (kg)	Analyses g/t							
		Cu	Pb	Bi	Au	Pd	Te	Sc	Fe
9280	1 000,0000	11	<2	<1	4	<5	<5	<5	<5
9281	2 000,0000	11	<2	<1	4	<5	<5	<5	<5
9282	2 000,0000	15	<2	<1	2	<5	<5	<5	<5
Total	5 000,0000								

Reinheitszertifikat über die Reinheit unserer Silberstaebe.  
 (C) BioParRes Hickmann

**Nur destilliertes Wasser ohne Zusatz verwenden !**

**Konzentration des kolloidalem Silbers in ppm. ( nur bei 200ml dest. Wasser )**

Beim erstem Mal dauert die Herstellung des kolloidalem Silbers das Doppelte der angegebenen Zeit. Beim zweitem Mal und bei allen weiteren Malen gibt man etwas altes KoSi bei der Neuherstellung als Starthilfe mit dazu ( 10-20ml ). Diese Zugabe füllt man sich nach jeder Herstellung in ein kleines Gefäß ab und hebt es für den nächsten Ansatz auf. Mit der Variante gelten die folgenden Angaben der Konzentration des KoSi in ppm.

- 25 min. = 10 ppm
- 30 min. = 12 ppm
- 50 min. = 20 ppm
- 60 min. = 25 ppm
- 90 min. = 50 ppm

( Ohne Starthilfe mit 10-20ml altem KoSi werden diese ppm-Konzentrationen erst in doppelter Herstellungszeit erreicht.)